203/2016 - Deliberazione - Allegato Utente 5 (A05)

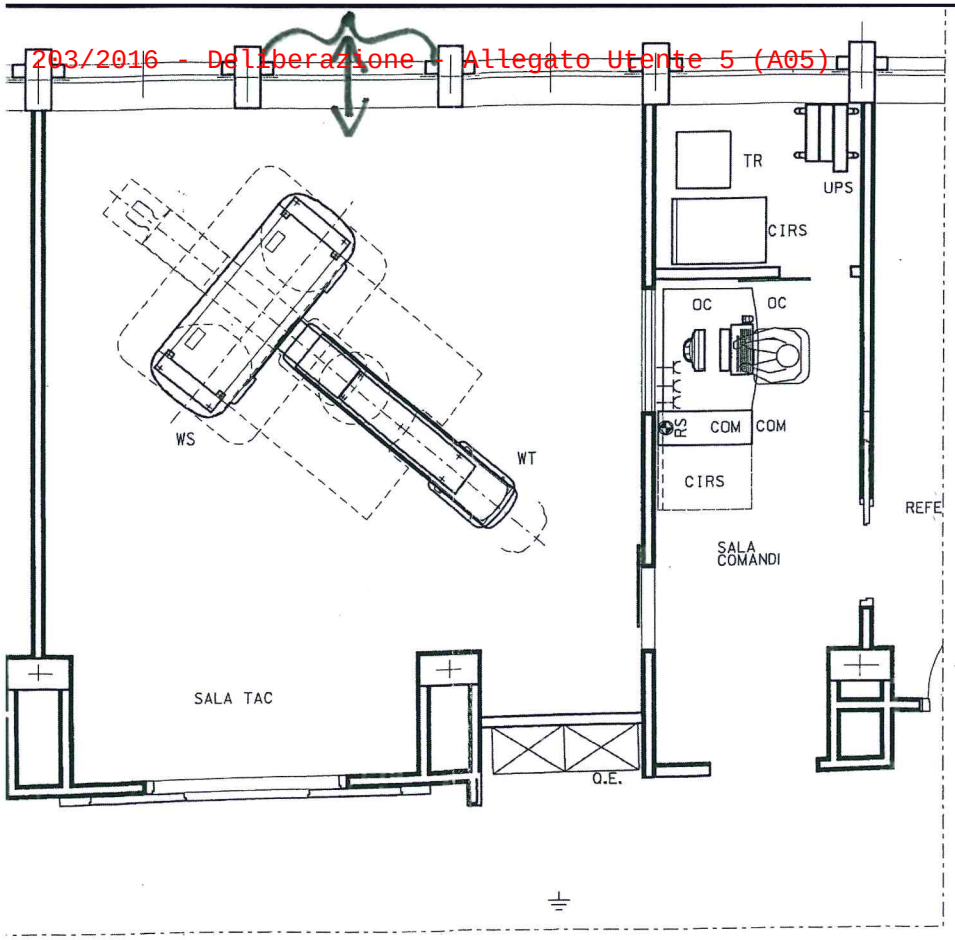

D ESISTENTE
E OPZIONALE

NR. OGGETTO

		DESCRIZIONE	WEIGHT KG	CALORE DISS. BTU/h	CALORE DISS. WATT	RUMORE a 1m dB (A)
A	WS	GANTRY	1941	20000	5860	-
A	WT	LETTINO PORTA PAZIENTE	383			-
A	OC	CONSOLLE OPERATORE	75	2559	750	-
A	COM	COMPUTER CABINET	120			-
A	CIRS	RECON CABINET	151	5293	1550	-
A	TR	TRASFORMATORE 380/480V	274	2210	650	
A	UPS	UPS WORKSTATION	130	1700	500	
A	WK	WORKSTATION - POSIZIONE INDICATIVA	75	1000	290	

CARATTERISTICHE AMBIENTALI RICHIESTE PER APPARECCHIATURA IN FUNZIONE

	SALA ESAME	SALA CONTROLLO	LOCALE con CIRS (RECON CABINET) LOCALE TECNICO
TEMPERATURA IDEALE	22 °C	22 °C	22 °C
TEMPERATURA LIMITI ASSOLUTI	21 °C / 24 °C	15 °C / 24 °C	21 °C / 24 °C
SBALZO TERMICO MAX	5 °C/h	9 °C/h	5 °C/h
UMIDITA' RELATIVA SENZA CONDENSAZIONE	30 / 60 %	35 / 70 %	30 / 60 %

CARATTERISTICHE ALIMENTAZIONE ELETTRICA

TENSIONE:	3F+N+T 380V
POTENZA MASSIMA RICHIESTA	80 KVA
IMPEDENZA DI RETE MAX :	0.200 ohm
CORRENTE ISTANTANEA MAX :	150 A

PRESA BIP+T 220 V 16A

RS NB. PREVEDERE PRESA RETE RJ45 PER REMOTE SERVICE (DA POSIZIONARE VICINO AL COMPUTER)

PRESA RJ 45 (RETE)

AZ. PROV. PER I SERVIZI SANITARI OSPEDALE "SANTA CHIARA" - TRENTO

PRONTO SOCCORSO -DIAGNOSTICA TAC D'URGENZA -PIANO RIALZATO CC